


**Analýza směsi spacerů; KOND – vodivostí detektor, UV – 230 nm (A), standardu 0,1 mg Bx/l (B) a vzorku 10x ředěného ethanolu s přidavkem 0,5 mg Bx/l (C)**



<sup>1</sup> Hay J.E., *Br. Pats.*, 955 309 and 955 310, (1960)

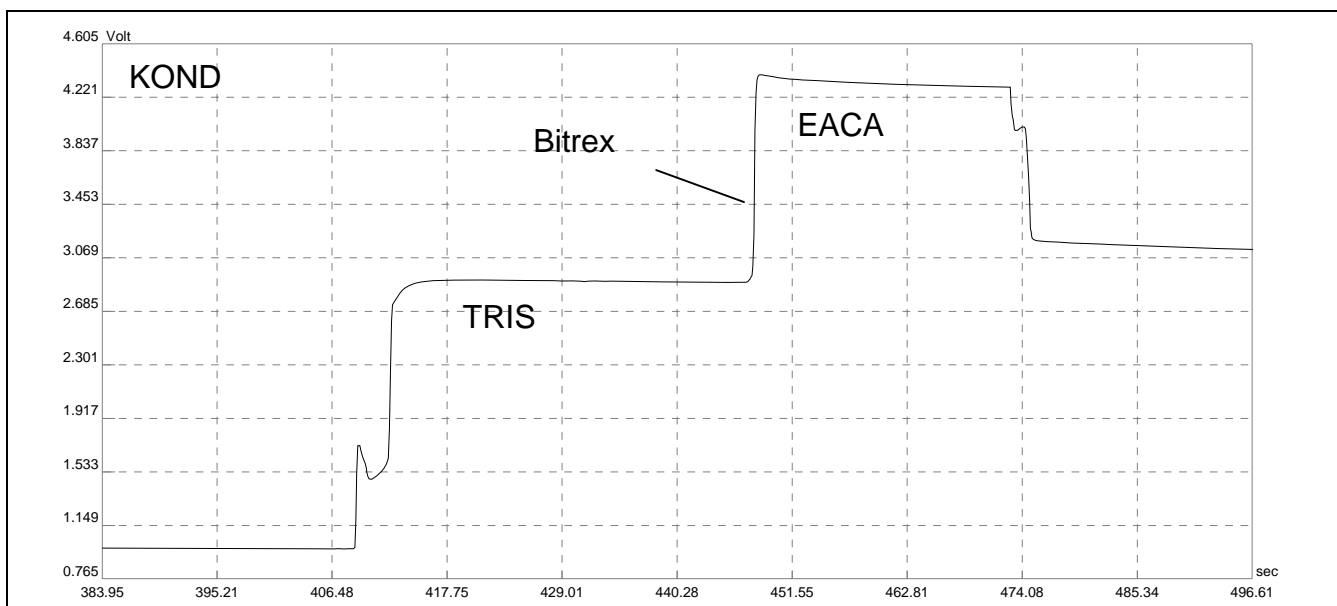